Installieren des Windows-Treibers für Ihr Spektralfotometer


Wenn Coraye Ihr Spektralfotometer beim Anschluss nicht erkennt, ist Ihr Spektralfotometer-Treiber wahrscheinlich nicht oder falsch installiert.

Treiber-Download


Die Treiber sind in den Coraye-Spektrophotometer-Plugins enthalten, die vom Dashboard heruntergeladen werden können: https://dashboard.coraye.com/plugins

In unserem Beispiel werden wir das für Konica Minolta MYIRO installieren.

1) Gehen Sie mit Ihrem bevorzugten Browser zum Dashboard
2) Wählen Sie das zu Ihrem Spektralfotometer passende Plugin aus.
3) Laden Sie das Plugin der Windows-Version herunter.
4) Nachdem die ZIP-Datei heruntergeladen wurde, entpacken Sie sie.

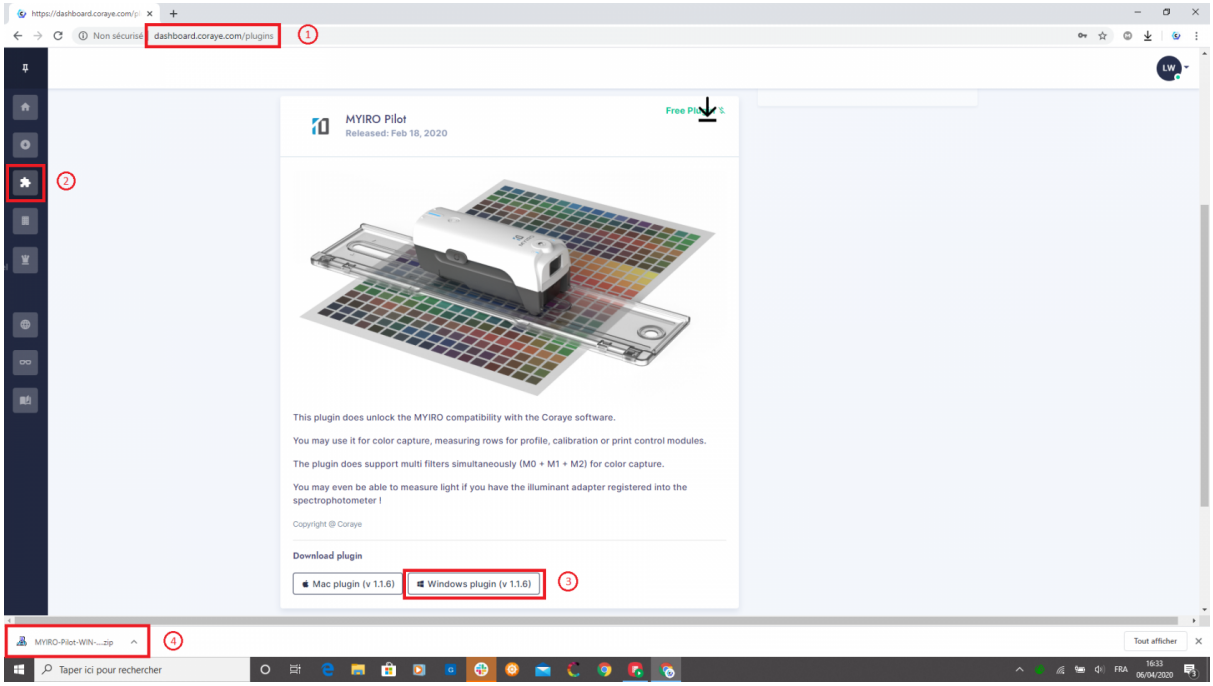

Entpacken Sie die Datei

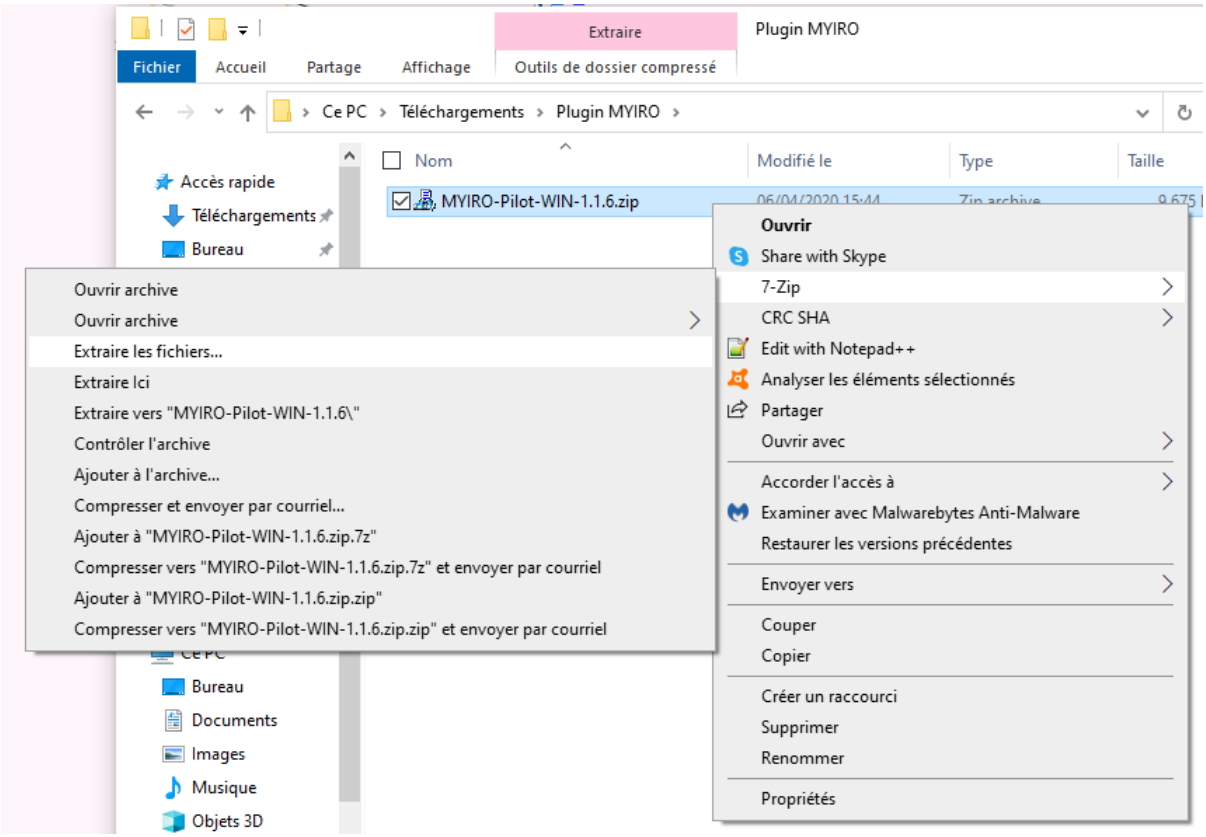


Sobald die Datei dekomprimiert ist, steht der Treiber für Windows 10 64 Bit im Ordner: C:\....\Plugin MYIRO\MYIRO-Pilot-WIN-1.1.6\lib\windows\x64


Treiberinstallation

Wenn Sie das Spektralfotometer zum ersten Mal anschließen, wird es im Windows-Geräte-Manager **als „USB Serial Device“ angezeigt.**


Dies bedeutet, dass der Treiber noch nie installiert wurde.

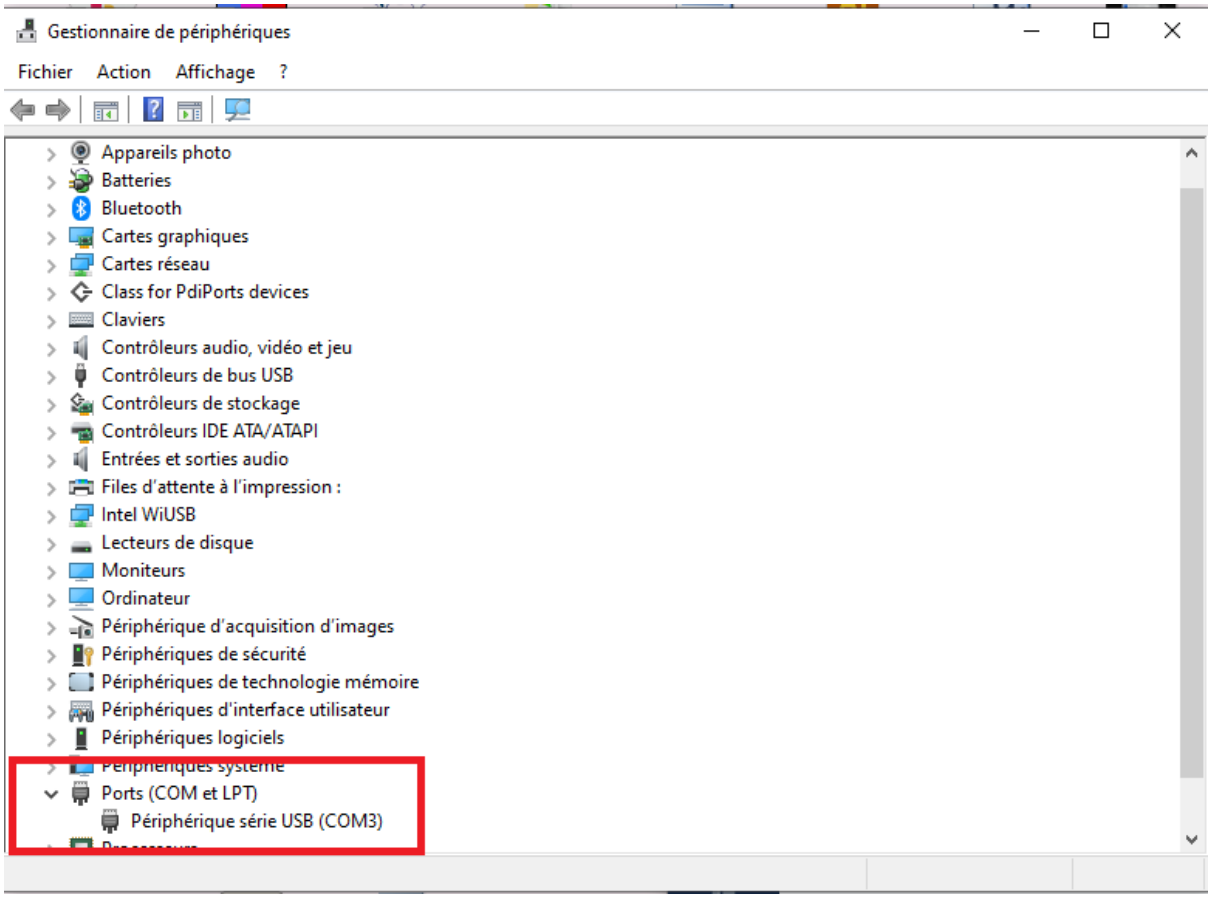


Um den Treiber zu installieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf " **USB-Seriell-Gerät** " und wählen Sie dann " **Treiber aktualisieren** ".

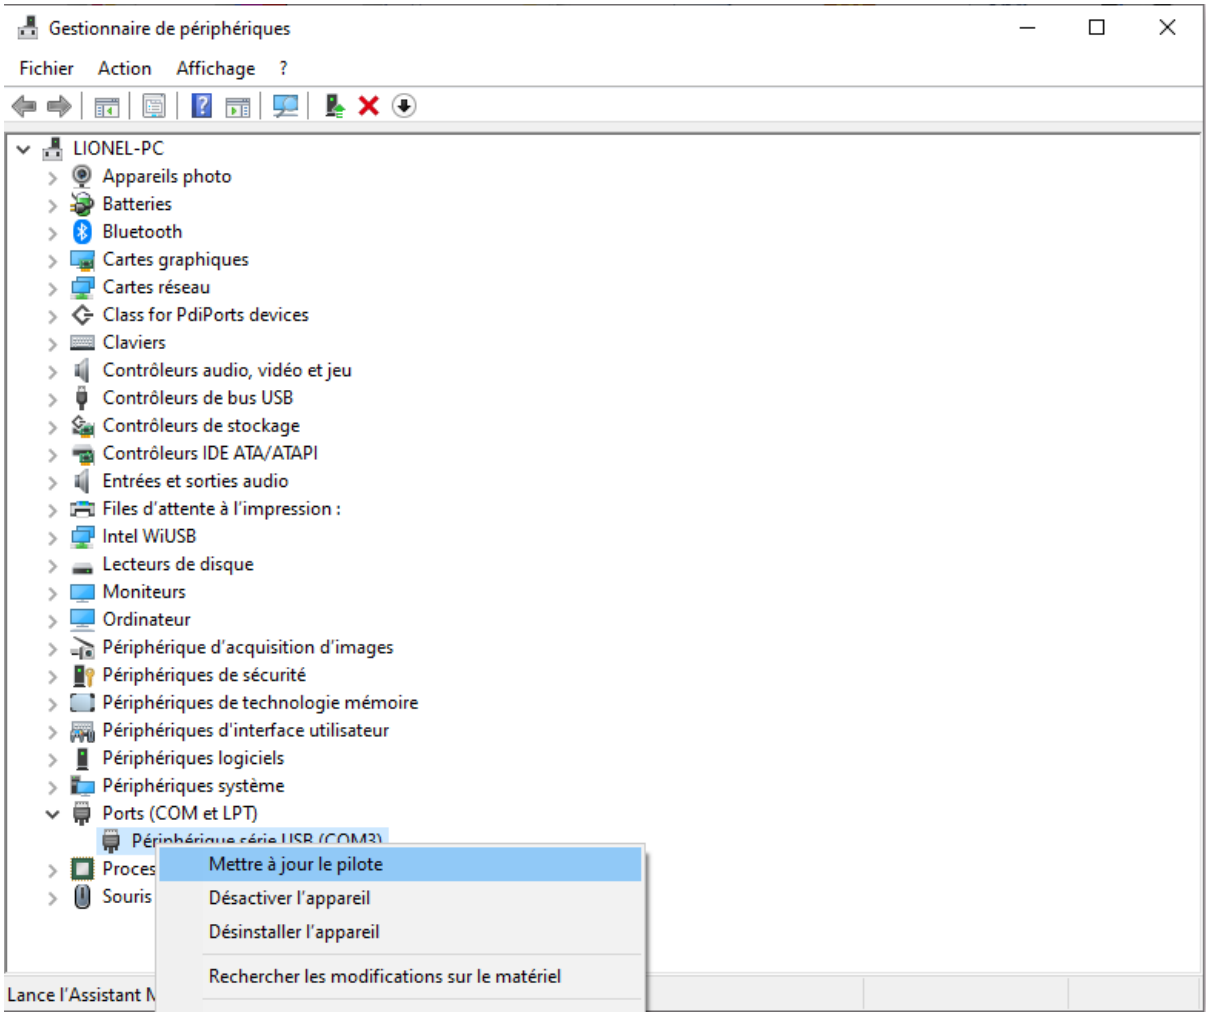


Wählen Sie " **Meinen Computer durchsuchen ...** " um den Pfad des Ordners anzugeben, in dem sich der Treiber befindet: C: \ .... \ Plugin MYIRO \ MYIRO-Pilot-WIN-1.1.6 \ lib \ windows \ x64

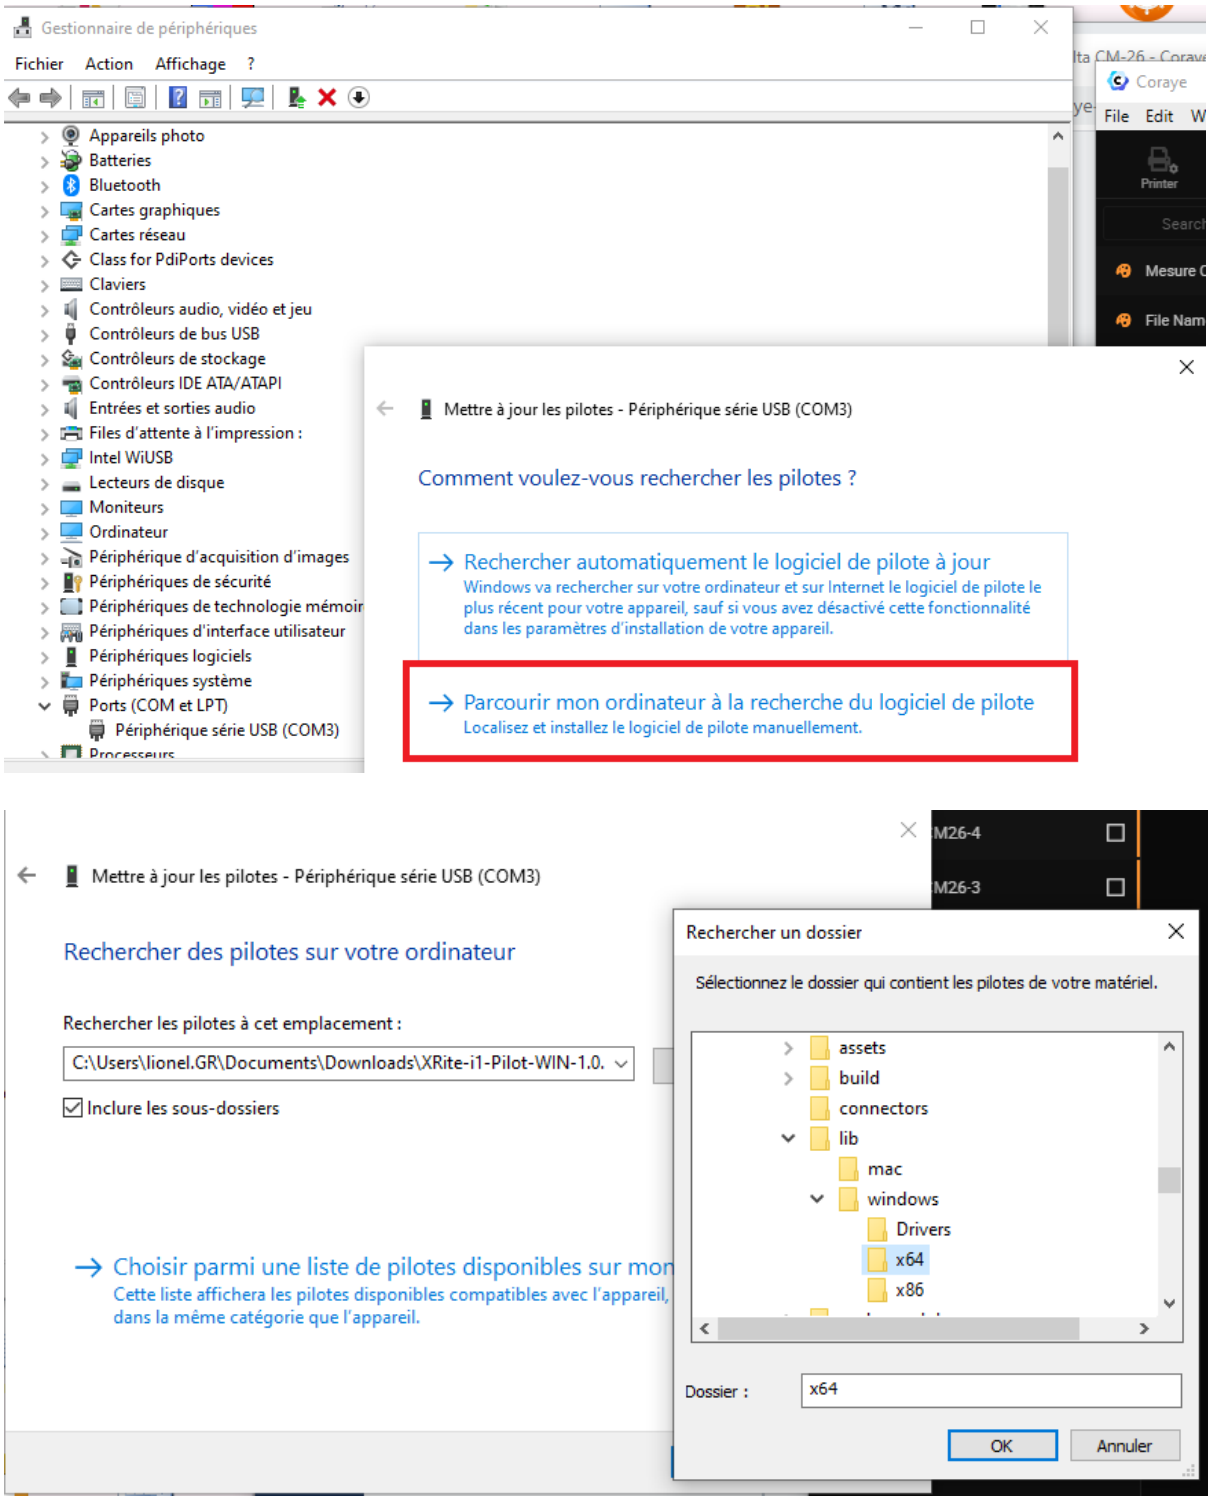

Wenn Sie den Pfad angegeben haben, klicken Sie auf " **Weiter** "

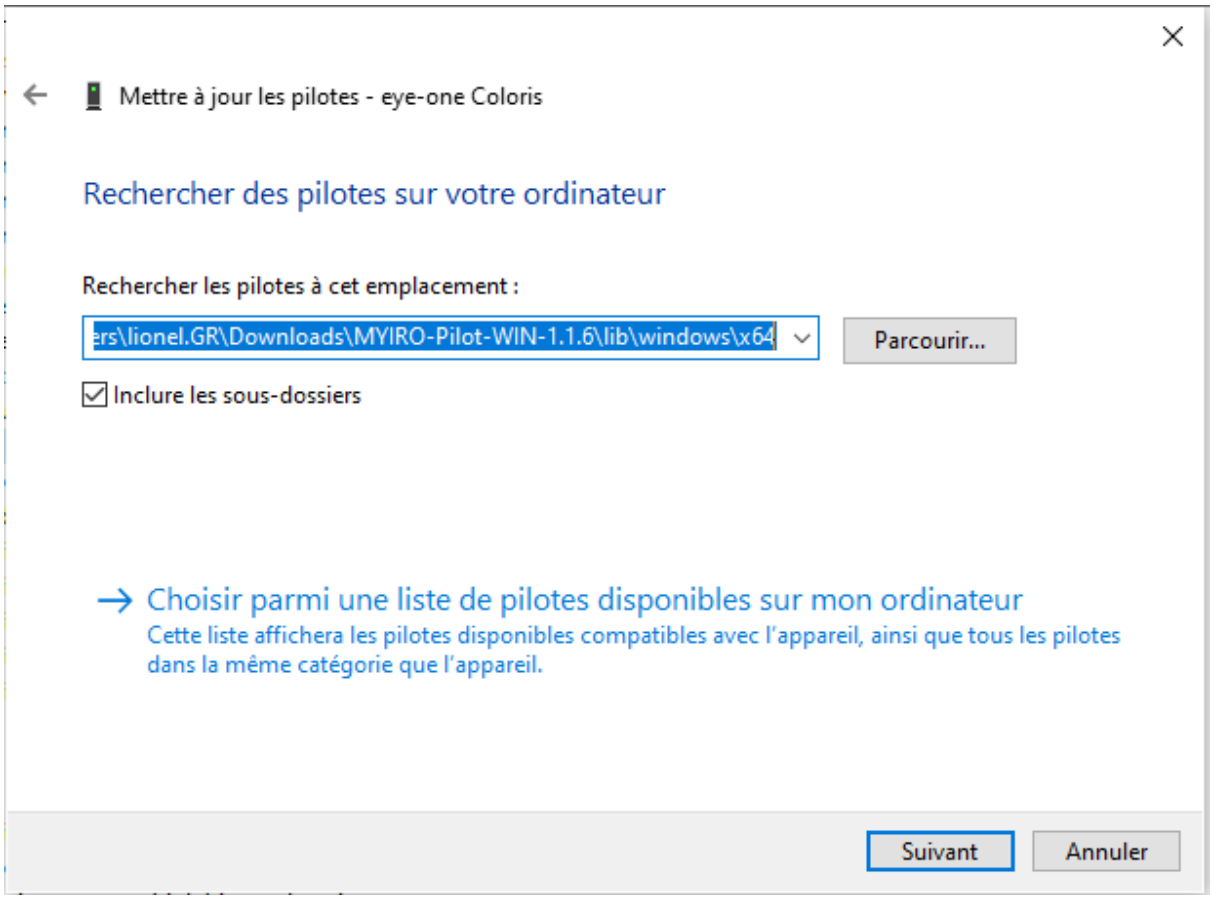

Der Treiber wird installiert und aus „ **USB Serial Device** “ wird „ **Measurement Instruments** “.
Dies bedeutet, dass der Treiber korrekt installiert ist. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **"Schließen"**

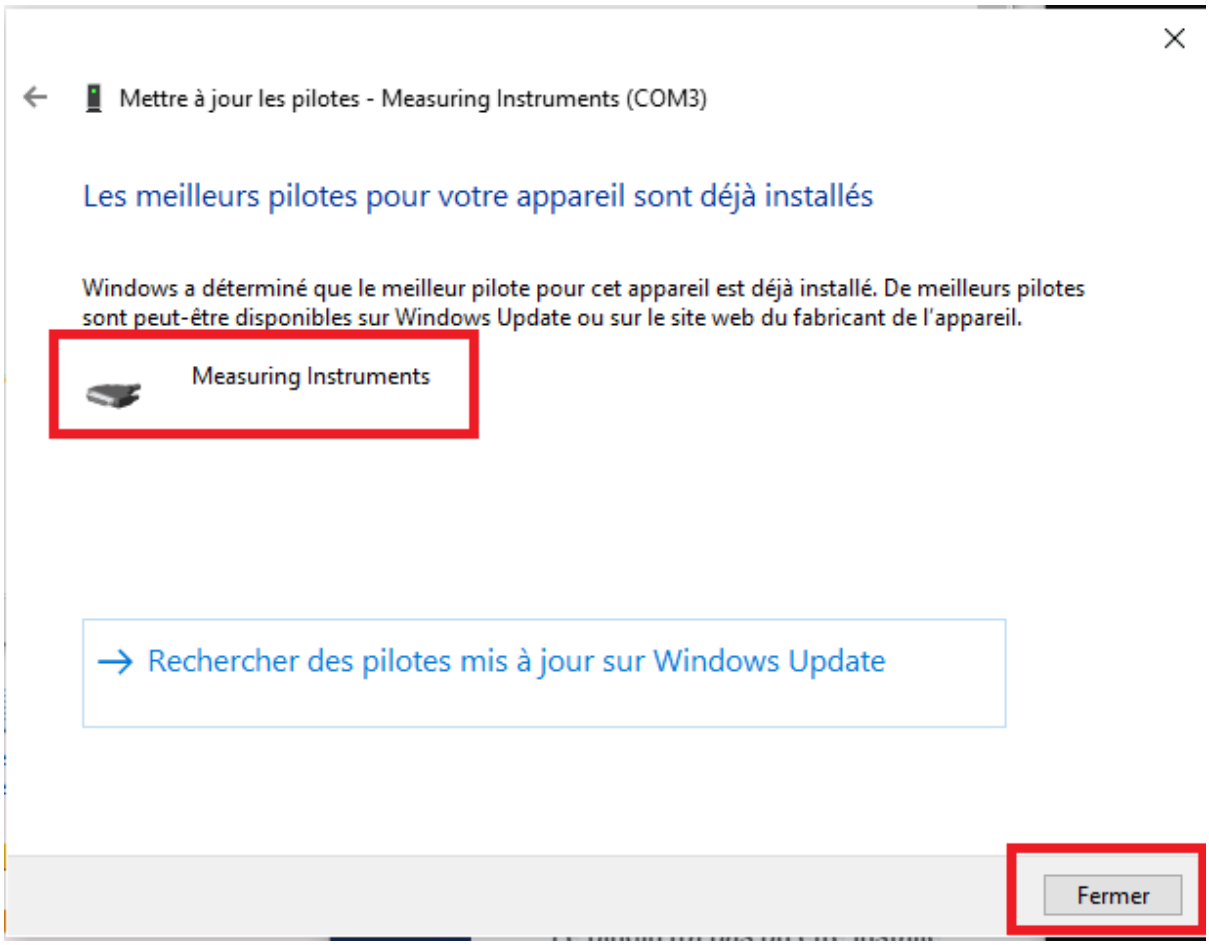

Jetzt sollte Ihr Spektralfotometer von Coraye erkannt werden.

Revision #1
Created 10 September 2021 12:34:20 by Lionel WETTEREN
Updated 12 October 2021 14:01:09 by Lionel WETTEREN